

Valvola di intercettazione passaparete

CE
Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Descrizione del prodotto

Le valvole di intercettazione di servizio sono necessarie per intercettare ogni porzione di impianto gas medicinali e vuoto; certificata dispositivo medico in accordo alla EN 7396-1; la valvola è completa di dado e controdado per il fissaggio a parate; fornita di portagomma per tubo medicale Ø6 e Ø8 (Vac) e da tubo a saldare Ø10 e Ø12 (Vac) dall'altra.
Tutti i materiali sono compatibili con l'ossigeno, forniti puliti e privi di tracce di olio, grasso o polvere.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 15001

Componenti

N.1 valvola a sfera miniball.
N.1 ingresso con tubo Ø10 mm / Ø12 mm.
N.1 uscita a portagomma Ø6 mm / Ø8 mm.
N.1 controdado in ottone nichelato chimicamente.


Dati tecnici


CODICE	DIMENSIONE VALVOLA	Ø TUBAZIONE (IN)	OUT	P. max	PESO	RDM
H1290	1/4"	10 mm	PG.Ø6 CON PASSAPARETE	63 bar	0.18 kg	2577402/R
H1290A	1/4"	12 mm	PG.Ø8 CON PASSAPARETE	63 bar	0.18 kg	2577403/R

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Immagini Tecniche

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA

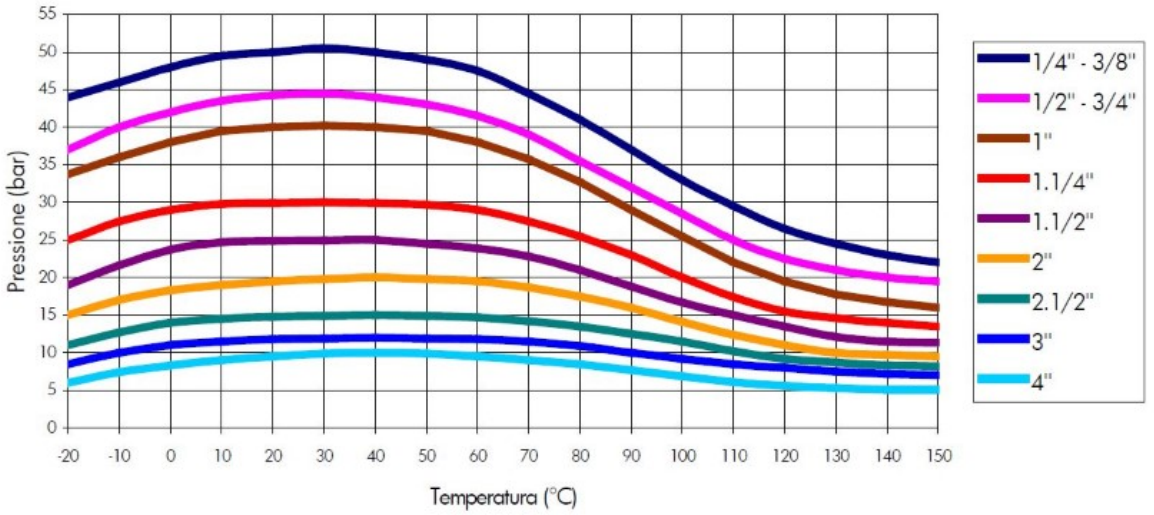

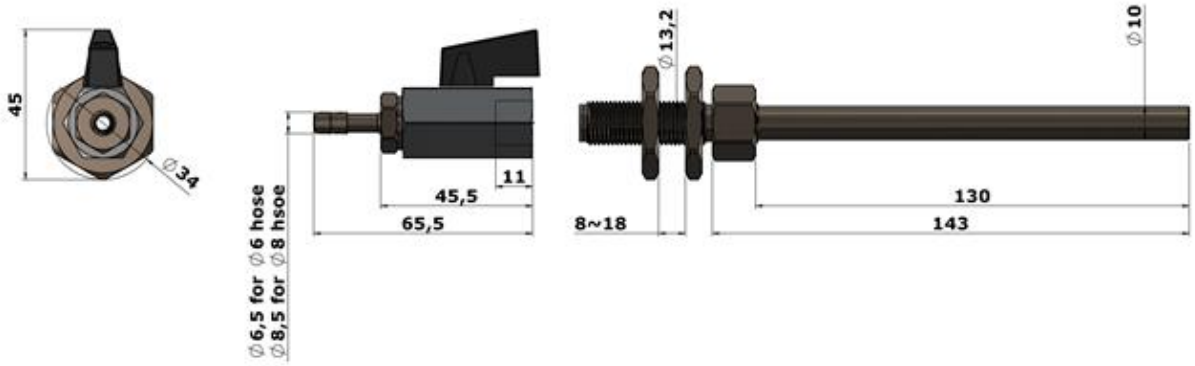

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998